


## Chi-Stabilisator nach Dr. Balck

Stuhl mit der zu behandelnden Person

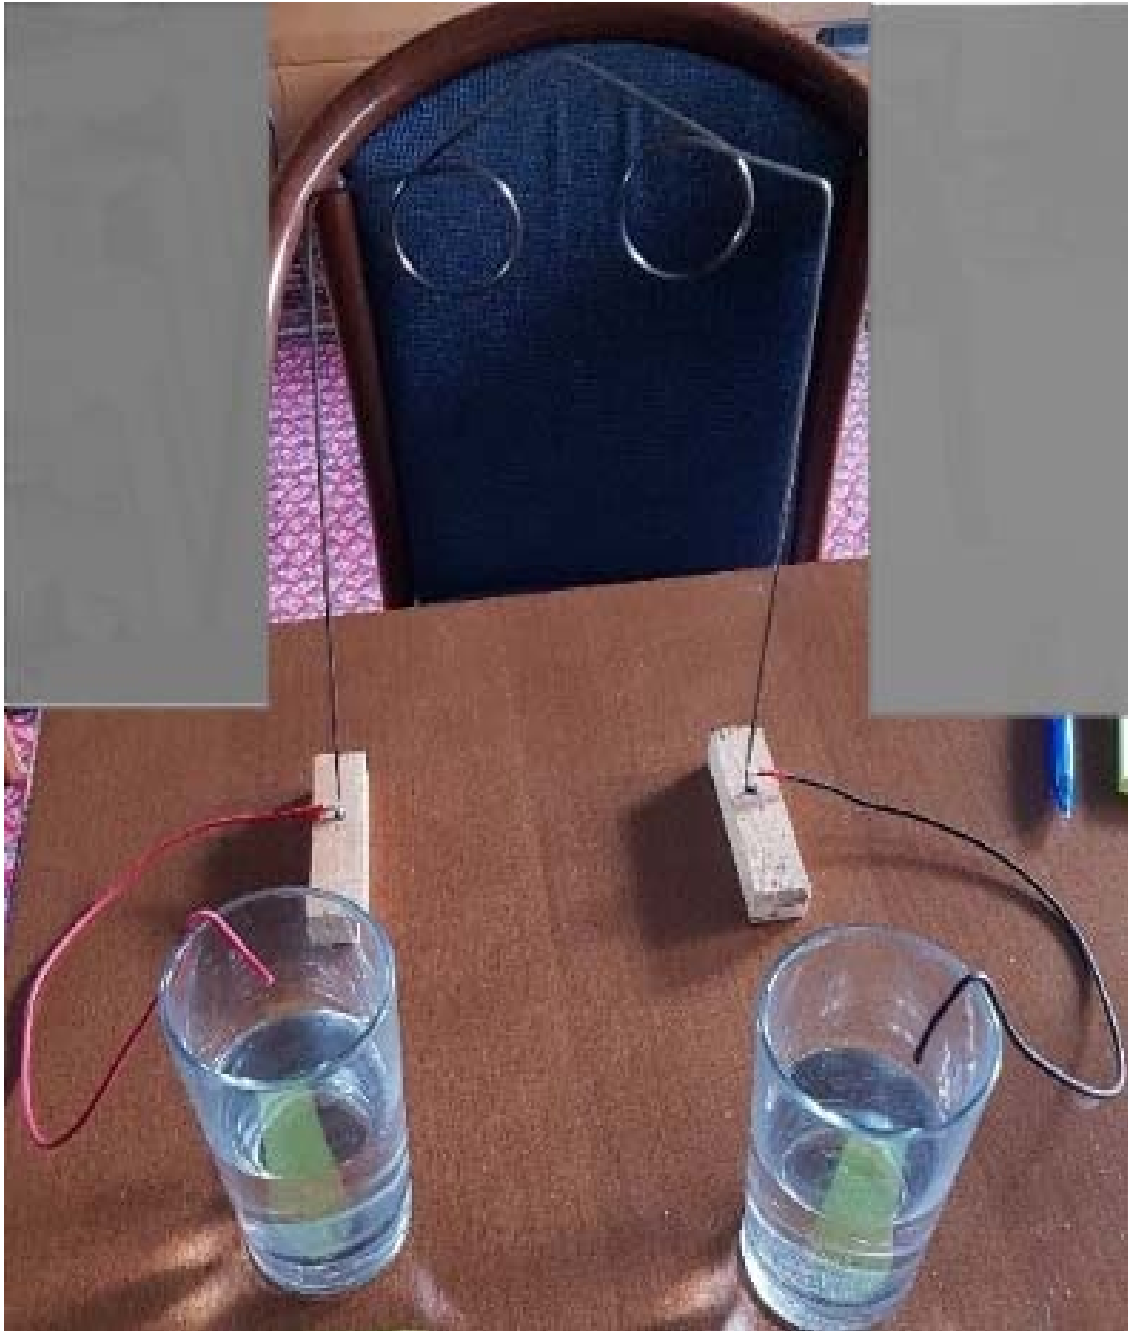

warm

kalt

Optimal bei Ausrichtung Nord-Süd.  
Einfacher Tisch,  
**keine Metallgegenstände oder Spiegel in der Nähe**

Die zu behandelnde Person sitzt auf einem Stuhl und blickt nach Norden. Vor ihr steht der Drahtbogen. Dieser ist so aufzustellen, dass von ihr aus gesehen der Schenkel mit dem Knick links und der Schenkel mit dem roten Schlauch rechts ist. Dahinter kommt links das Glas (K) mit kaltem und rechts das Glas (W) mit dem warmen Wasser. Jeder Schenkel ist mit einem Zuleitungsdraht zu verbinden.

Zum Einschalten der Wirkung werden die anderen Enden der Zuleitungsdrähte jeweils mit den Wassergläsern verbunden (mechanischer Kontakt reicht aus), zum Abschalten sind sie zu entfernen (Mindestabstand etwa 10 cm zu den Gläsern).

Behandlungszeit: 30 s bis 120 s bei 30° Temperaturdifferenz  
(je höher die Differenz, umso wirksamer)

Es empfiehlt sich, das Wasser im Glas (K) alsbald zu entsorgen.  
Das W-Wasser ist auch noch nach dem Erkalten für andere Anwendungen geeignet.

Der Aufenthalt im Bereich hinter den Wassergläsern während der Anwendung ist zu vermeiden.

Igensdorf 10.12.2025